


SISTEMA med 92.2

Schema generale

COMANDO A DISTANZA
SERRATURE PORTIERE

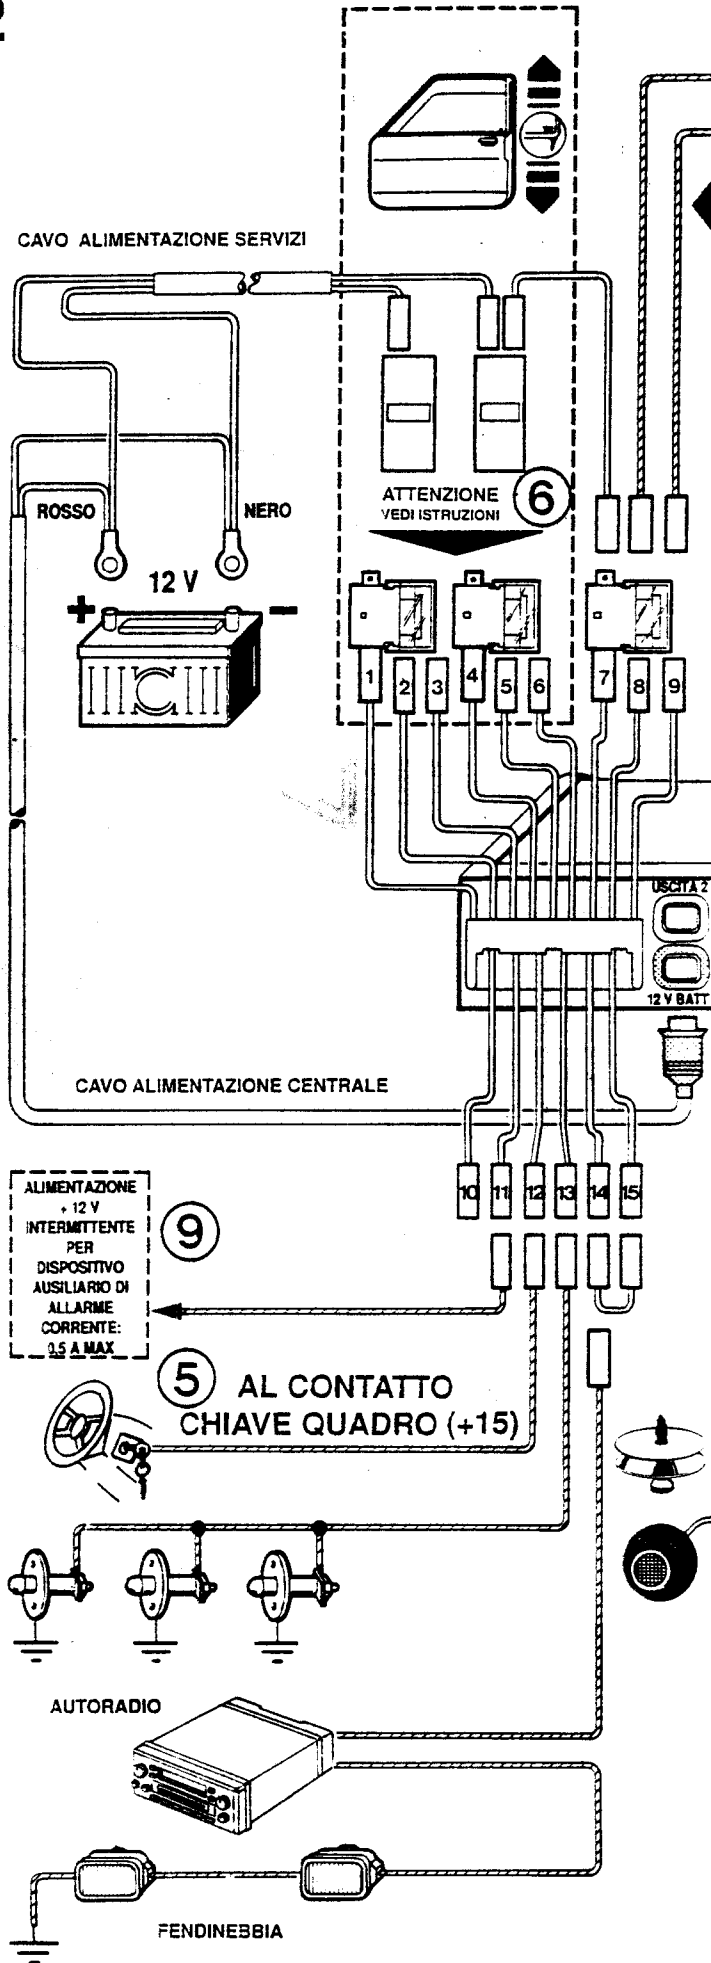

② PROTEZIONE PERIFERICA

③ PROTEZIONE ACCESSORI

ALIMENTAZIONE + 12 V INTERMITTENTE PER DISPOSITIVO AUSILIARIO DI ALLARME CORRENTE: 1.5 A MAX

⑤ AL CONTATTO CHIAVE QUADRO (+15)

ATTENZIONE VEDI ISTRUZIONI ⑥

CAVO ALIMENTAZIONE SERVIZI

CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALE


AUTORADIO

FENDINEBBIA


USCITA 2
12 V BATT

SEGNALAZIONI
OTTICHE

4




UCI DI DIREZIONE




SIRENA med 025

8

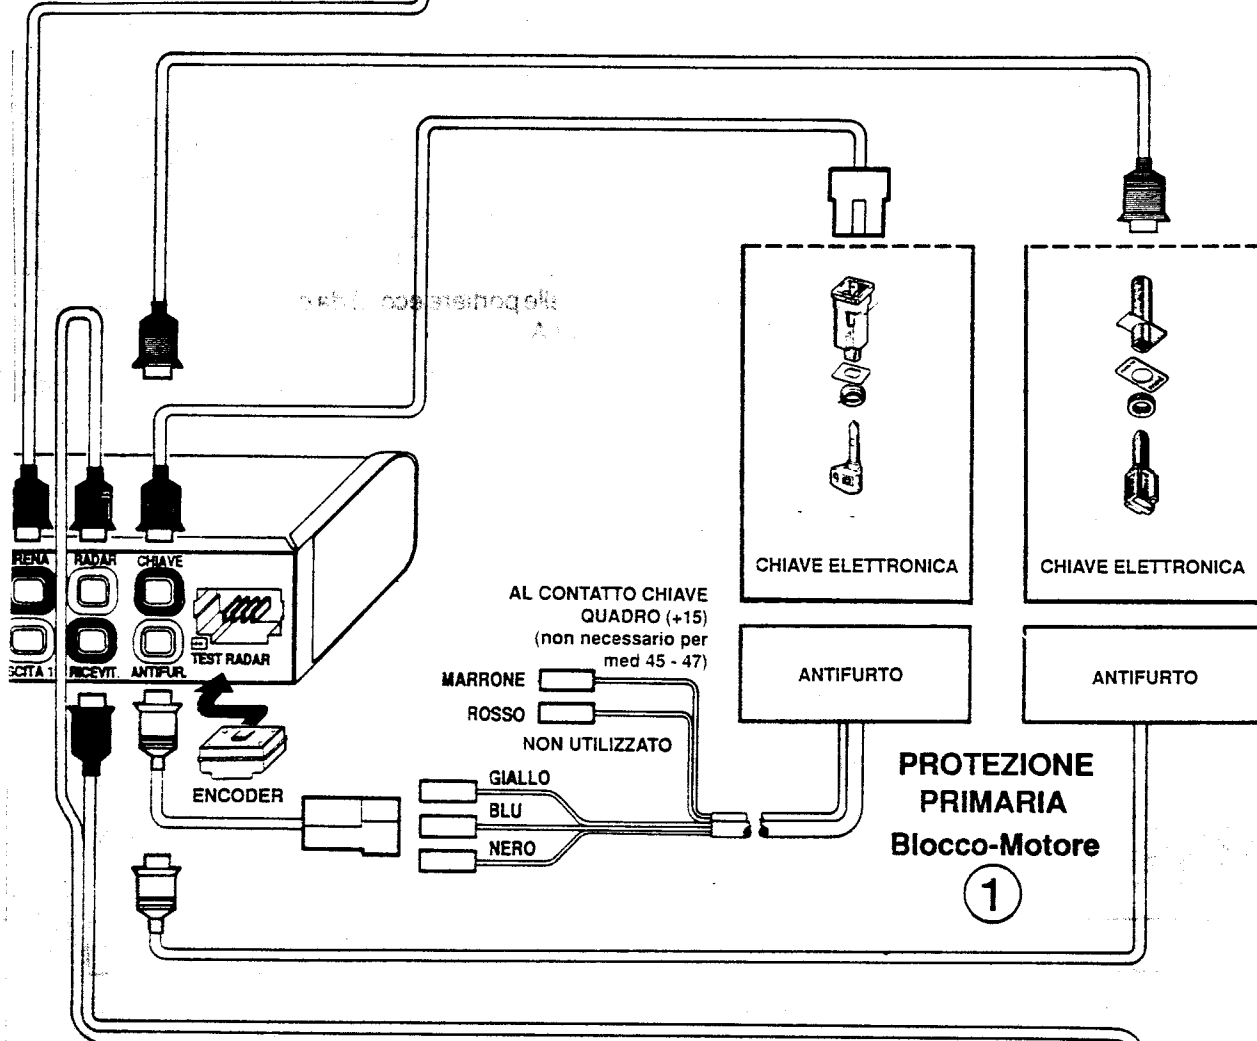

AL CONTATTO CHIAVE
QUADRO (+15)
(non necessario per
med 45 - 47)



CHIAVE ELETTRONICA

CHIAVE ELETTRONICA

ANTIFURTO

ANTIFURTO


PROTEZIONE
PRIMARIA
Blocco-Motore

1

PROTEZIONE VOLUMETRICA



SUPPORTO SENSORI

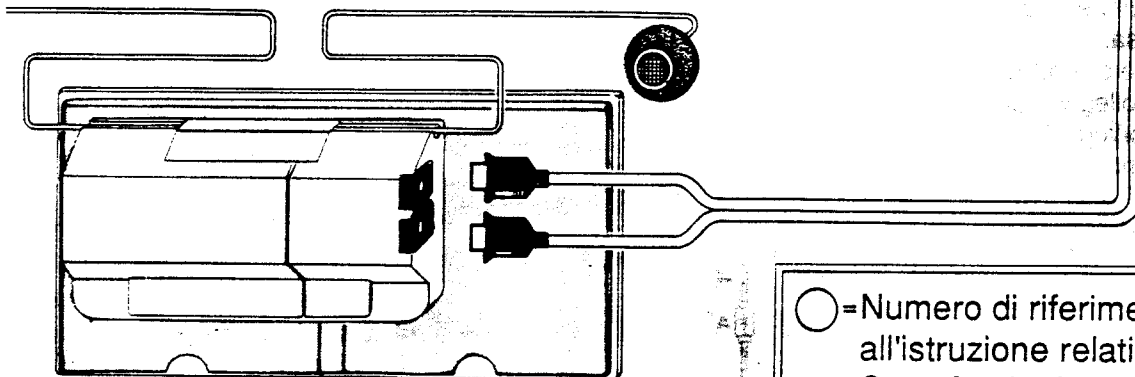

RADAR - RICEVITORE 7

- = Numero di riferimento all'istruzione relativa
- = Cavo fornito in confezione
- - - = Cavo dell'impianto originale
- ▨ = Cavo aggiunto